

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Oława, dn.17.01.2018.

ZOZ/DZP/PN/1/18

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego - różne, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/18**

Pytanie nr 1, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wyjmowania wypełnienia szczytów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne 1 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści szerokość całkowitą bez lub z barierkami 1020 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem, z leżem 2000x900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne 1 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści szerokość całkowitą bez lub z barierkami 970 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem, z leżem 2000x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne 1 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szczyty malowane wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne 1 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szczyty wykonane z tworzywa ABS co jest parametrem lepszym do oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 10, Dotyczy: Zadanie nr 7, Łóżko medyczne hydrauliczne 1 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści leże wykonane z metalowych paneli o szerokości 80 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, Dotyczy: Zadanie 1 Wózek anestezjologiczny 2 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 640 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o szerokości 640 mm.

Pytanie nr 12, Dotyczy: Zadanie 1 Wózek anestezjologiczny 2 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 20 uchwyt na pudełko z rękawiczkami zamiast koszyka na rękawiczki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt na pudełko z rękawiczkami.


Pytanie nr 13, Dotyczy: Zadanie 1 Wózek anestezjologiczny 2 szt

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Plac - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28

1



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 22 uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na ostre odpady?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14, Dotyczy: Zadanie 1 Wózek anestezyjologiczny 2 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 26 szyny montażowe ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szyny montażowe ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 15, Dotyczy: Zadanie 1 Wózek anestezyjologiczny 2 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 28 uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x 78 x 460 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x 78 x 460 mm.

Pytanie nr 16, Dotyczy: Zadanie 1 Wózek anestezyjologiczny 2 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 30 metalowe uchwyty szuflad chromowane lub lakierowane (8 kolorów do wyboru)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza metalowe uchwyty szuflad chromowane lub lakierowane (8 kolorów do wyboru).

Pytanie nr 17, Dotyczy: Zadanie 2, Wózek reanimacyjny 1 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 640 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o szerokości 640 mm

Pytanie nr 18, Dotyczy: Zadanie 2, Wózek reanimacyjny 1 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 23 uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na ostre odpady/elementy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19, Dotyczy: Zadanie 2, Wózek reanimacyjny 1 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 25 uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x 78 x 460 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt na cewniki o wymiarach 117 x 78 x 460 mm.

Pytanie nr 20, Dotyczy: Zadanie 2, Wózek reanimacyjny 1 szt

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 26 uchwyt na pudełko z rękawiczkami zamiast koszyka na rękawiczki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt na pudełko z rękawiczkami.

Pytanie nr 21, Dotyczy: Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl.

Prosimy o dopuszczenie pasów na kostki w rozmiarze L: 24-28 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pasy magnetyczne w rozmiarze L: 24-28 cm.

Pytanie nr 22, Dotyczy:

Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl., Warunki gwarancji i terminy dostaw, pkt.3, 4, 5, 6, 7, 8

Z uwagi na fakt, iż w pasach nie ma możliwości naprawiania jakichkolwiek części, a są one jedynie objęte gwarancją na wady fabryczne, prosimy o odstąpienie od wymogów gwarancji (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8), jako że są to warunki określające naprawy sprzętu medycznego, w którym ulec uszkodzeniu mogą elementy elektryczne, mechaniczne bądź elektroniczne, podlegające naprawie lub wymianie. W pasach można jedynie określić czas wymiany uszkodzonego pasa lub zamka magnetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23, Dotyczy: Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl., Warunki gwarancji i terminy dostaw, Pkt. 3, 4, 5

Prosimy o zmianę zapisu na: termin wymiany pasa, który podlega wymianie z uwagi na wady fabryczne - 3 dni

Odpowiedź: Zamawiający uzna wymię pasa na nowy, jako naprawę.

Pytanie nr 24, Dotyczy: Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl., Warunki gwarancji i terminy dostaw, Pkt. 6

Prosimy o zmianę zapisu na: Przedłużenie okresu gwarancji o czas wymiany pasa

Odpowiedź: Zamawiający uzna wymię pasa na nowy, jako naprawę.

Pytanie nr 25, Dotyczy: Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl, Warunki gwarancji i terminy dostaw, Pkt. 7

Prosimy o zmianę zapisu na: Pas o wadach fabrycznych, podlega wymianie

Odpowiedź: Liczba napraw powodująca obowiązkową wymianę na nowy w okresie gwarancji-3.

Pytanie nr 26, Dotyczy: Zadanie 4, Pasy magnetyczne 1 kpl, Warunki gwarancji i terminy dostaw, Pkt. 8

Prosimy o zmianę zapisu na: wymianę, sprzedaż części zamiennych na terenie Polski prowadzi: podać

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27, Dotyczy: Zadanie 5, Poz. 5, 6, 7

Prosimy o wydzielenie pozycji 5, 6, 7 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28, Dotyczy: Zadanie 9, Pkt. 5

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo rolkowego z taśmą w kolorze czarnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przenośnik taśmowo rolkowy z taśmą w kolorze czarnym.

Pytanie nr 29, Dotyczy: Zadanie 9, Pkt. 5, Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo – rolkowego o wymiarach 760 x 360 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, o wymiarach zewnętrznych bez zamontowanego wyposażenia i akcesoriów:

- szerokość: 650mm,

- głębokość: 475mm, ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, o wysokości (do blatu): 970mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 4. i 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wykonane są z wytrzymałego, nierdzewnego kompozytu aluminium – w celu zredukowania masy wózka, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo na wybrany kolor?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej – co ogranicza namnażanie się bakterii i ognisk infekcji szpitalnych? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek anestesjologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 34, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, którego ładowność całkowita wynosi 200kg? Natomiast max. ładowność pojedynczej szuflady wynosi 50kg? Co za tym idzie max. obciążenie robocze przypadające na jedno koło wynosi +/- 50kg przy pełnym obciążeniu. Z Państwa opisu w pkt. 10 wózka anestesjologicznego wynika, że wymagają Państwo wózka o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej $4 \times 150\text{kg} = 600\text{kg}$ -- nie ma na rynku polskim wózka anestesjologicznego o takim dopuszczalnym obciążeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek anestesjologiczny, którego ładowność całkowita wynosi 200kg, a max. ładowność pojedynczej szuflady wynosi 50kg.

Pytanie nr 35, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, wyposażony w 5 szuflad, o wysokościach użytkowych (od dolnej): 1x 23cm, 4x 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, wyposażony w nadstawkę anestesjologiczną z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami na leki i akcesoria? Poniżej zdjęcie prezentujące opisywane rozwiązanie:



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658




tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

ISO 9001:2008

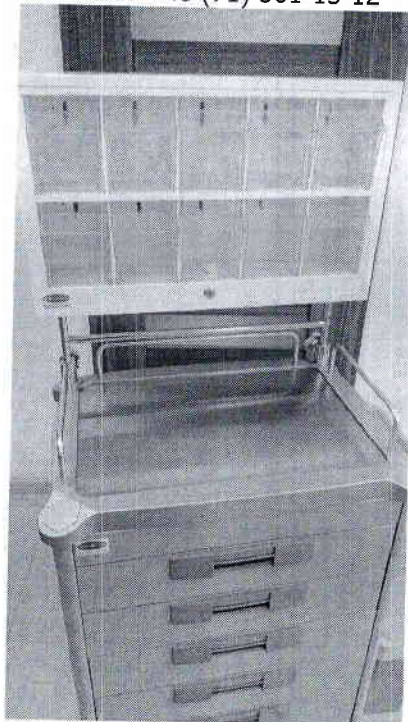

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 25.


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, który zamiast listwy odbojowej na podstawie, posiada wyprofilowane nad kołami solidne odboje z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek anestesjologiczny, który posiada wyprofilowane nad kołami solidne odboje z tworzywa.

Pytanie nr 38, Dotyczy: Zadanie 1. Wózek anestesjologiczny – 2szt. Pkt. 31.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestesjologiczny, wyposażony w nierdzewny kosz o wymiarach 100x 100 x 480mm na cewniki, oraz jeden dodatkowy uchwyt na cewniki mocowany do szyny?

Poniżej znajdują się zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39, Dotyczy: Zadanie. 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, o wymiarach zewnętrznych bez zamontowanego wyposażenia i akcesoriów:

- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm, ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40, Dotyczy: Zadanie. 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wysokości (do blatu): 970mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41, Dotyczy: Zadanie. 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 4. i 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wykonane są z wytrzymałego, nierdzewnego kompozytu aluminium – w celu zredukowania masy wózka, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo na wybrany kolor?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42, Dotyczy: Zadanie 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej – co ogranicza namnażanie się bakterii

i ognisk infekcji szpitalnych? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej


Pytanie nr 43, Dotyczy: Zadanie 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego ładowność całkowita wynosi 200kg? Natomiast max. ładowność pojedynczej szuflady wynosi 50kg? Co za tym idzie max. obciążenie robocze przypadające na jedno koło wynosi +/- 50kg przy pełnym obciążeniu. Z Państwa opisu w pkt. 10 wózka anestezjologicznego wynika, że wymagają Państwo wózka o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej $4 \times 150\text{kg} = 600\text{kg}$ – nie ma na rynku polskim wózka reanimacyjnego o takim dopuszczalnym obciążeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny, którego ładowność całkowita wynosi 200kg, a max. ładowność pojedynczej szuflady wynosi 50kg.

Pytanie nr 44, Dotyczy: Zadanie 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny,



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

wyposażony w 5 szuflad, o wysokościach użytkowych (od dolnej): 1x 23cm, 4x 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45, Dotyczy: Zadanie 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w centralny zamek wszystkich szuflad, zamiast plomby pierwszej szuflady?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46, Dotyczy: Zadanie 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 27.




Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, który zamiast listwy odbojowej na podstawie, posiada wyprofilowane nad kołami solidne odboje z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny który zamiast listwy odbojowej na podstawie, posiada wyprofilowane nad kołami solidne odboje z tworzywa.

Pytanie nr 47, Dotyczy: Zadanie 2. Wózek reanimacyjny – 1szt. Pkt. 28.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego ściany boczne i tylnia są koloru szarego – co narzuca zastosowany nierdzewny kompozyt aluminium – natomiast fronty szuflad są stalowe - lakierowane proszkowo na dowolny wskazany kolor?

Poniżej znajdują się zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

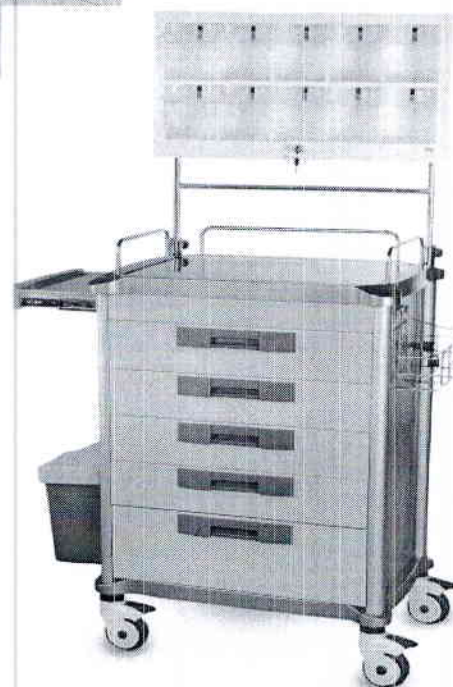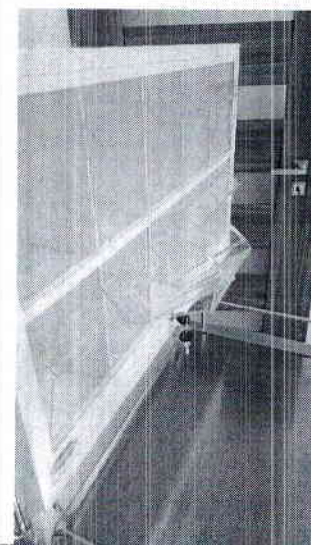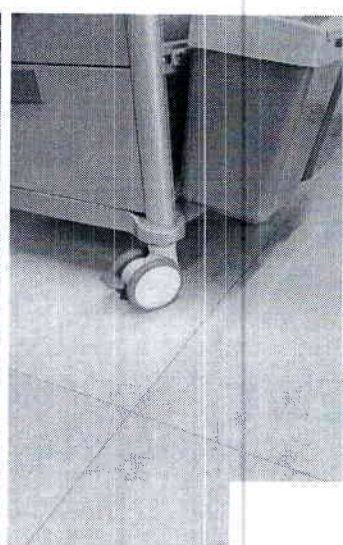

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamów
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658




ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

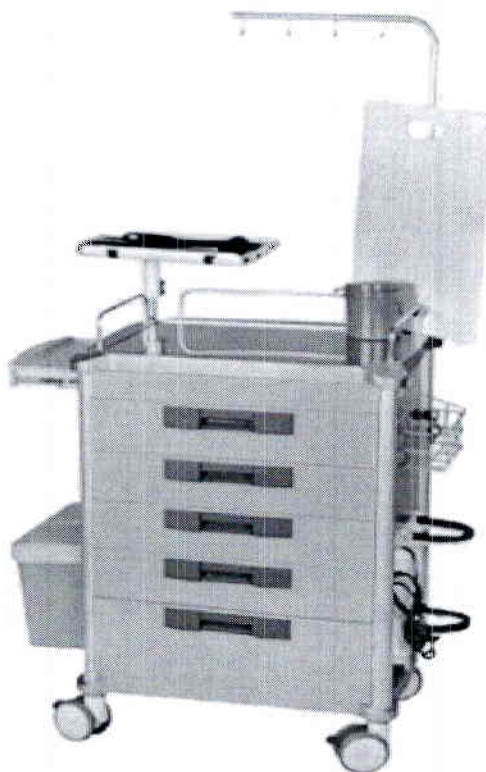

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48, Dotyczy: Zadanie 12 Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO₂)- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści inkubator niebędący sprzętem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010 r. ale posiadający certyfikat CE? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49, Dotyczy: Zadanie 12 Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO₂)- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych (wys. x szer. x głęb.) 717 mm x 534 mm x 460 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w związku z ograniczonym miejscem w pracowni bakteriologicznej.

Pytanie nr 50, Dotyczy: Zadanie 12 Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO₂)- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wadze 40 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę inkubatora z regulowaną atmosferą gazową (CO₂) o wadze do 40 kg.

Pytanie nr 51, Dotyczy: Zadanie 12 Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO₂)- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w czujnik pomiaru CO₂ wysokostabilny, na podczerwień (czujnik IR)? Czujniki tego typu cechują się większą selektywnością, a wysoka wilgotność w komorze nie wpływa na wyniki jego pomiarów. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52, Dotyczy: Zadanie 12 Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO₂)- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +60°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO₂) o zakresie regulacji temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +60°C

Pytanie nr 53, Dotyczy: Zadanie 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-85°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-85°

Pytanie nr 54, Dotyczy: Zadanie 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28

7



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830.

Pytanie nr 55, Dotyczy: Zadanie 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją anty-Trendelenburga 0-18° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją anty-Trendelenburga 0-18°

Pytanie nr 56, Dotyczy: Zadanie 7, Łóżko medyczne hydrauliczne – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej obudowy podwozia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57, Dotyczy: Zadanie 9 Przenośnik taśmowo-rolkowy - 3 szt, dot. Załącznik nr 2-9, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośnik taśmowy w kolorze szarym z elementami niebieskimi ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przenośnik taśmowy w kolorze szarym z elementami niebieskimi.

Pytanie nr 58, Dotyczy: Zadanie 9 Przenośnik taśmowo-rolkowy - 3 szt, dot. Załącznik nr 2-9, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośnik taśmowy o wymiarach długość 126 cm, a szerokość 40 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59, Dotyczy: Zadanie nr: 1 - Wózek anestezyjologiczny 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemysłowej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:

- Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: 662 x 594 x 1050 h mm
- Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium
- Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
- Błat wykonany z odpornego tworzywa ABS
- Układ jezdnny wysoce mobilny: 4 obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z blokadą, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wys. 76 h mm
 - 2 szuflady o wys. 156 h mm
 - 1 szuflada o wys. 236 h mm
- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad na klucz
- Szuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości
- Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, czoła szuflad z miejscem na umieszczenie opisu zawartości, z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
- Ładowność jednej szuflady do 45 kg
- Błat z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów
- Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka
- Wysuwany dodatkowy błat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu do 10 kg
- Wózek wyposażony w kosz na odpady otwierany kolanem
- Z tyłu wózka, wbudowana w jego konstrukcję specjalna przestrzeń na pudełko z rękawiczkami
- Uniwersalne dwie transparentne odchylane kieszenie oraz półka z boku wózka
- Przestrzeń na pojemnik na odpady ostre z pasem mocującym, wbudowany w tylną konstrukcję wózka
- Nad blatem wózka nadstawka w postaci półki
- Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS
- Aluminiowe szyny montażowe na nadstawce
- Ściany boczne oraz tył wózka w kolorze turkusowym (jak na poniższym zdjęciu poglądowym)
- Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad z tworzywa (9 kolorów oznaczeń do wyboru)
- Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach
- Uchwyt na płyny infuzyjne z 2 haczykami
- Z boku wózka dodatkowy kosz na cewniki



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12
(Poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

www.zozolawa.wroc.pl



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60, Dotyczy: Zadanie nr: 2 - Wózek reanimacyjny 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemysłowej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:

- Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: 662 x 594 x 1050 h mm
- Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium
- Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
- Błat wykonany z odpornego tworzywa ABS
- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z blokadą, 2 antystatyczne, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wys. 76 h mm
 - 2 szuflady o wys. 156 h mm
 - 1 szuflada o wys. 236 h mm
- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich pięciu szuflad – bezpieczny zamek szuflad odblokowywany / zablokowany jednym ruchem; dodatkowe zabezpieczenie za pomocą plomb (na wyposażeniu 100 plomb)
- Szuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości
- Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, czoła szuflad z miejscem na umieszczenie opisu zawartości, z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
- Ładowność jednej szuflady do 45 kg
- Dwie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki z tworzywa z możliwością dowolnej konfiguracji przegród
- Błat z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów
- Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka
- Wysuwany dodatkowy błat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu do 10 kg
- Półka pod defibrylator z regulacją szerokości, obrotowa
- Wieszak na płyny infuzyjne z 2 haczykami
- Płyta do reanimacji
- Koszyn na pojemnik na odpady ostre



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

- Akcesoria instalowane na 2 szynach z prawej strony wózka
- Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach
- Uchwyt na pudełko na rękawiczki wieszany na szynie
- Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS
- Ściany boczne oraz tył wózka w kolorze pomarańczowym (jak na poniższym zdjęciu poglądowym)
- Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad z tworzywa (9 kolorów oznaczeń do wyboru)
- Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, w tylnej ścianie wózka
- Przezroczyste 2 odchylane kieszenie
- Półka na ssak o regulowanej głębokości
(Poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61, Dotyczy SIWZ dla: Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2:

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia użytkowników wózków. Oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62, Dotyczy SIWZ dla: Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia dla zadań 1 i 2, tj. 6 tyg. od dnia podpisania umowy. Zachowanie przez Zamawiającego tylko takiego terminu realizacji będzie gwarantowało Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zobowiązania przez oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
lek. med. Andrzej Dronsejko